

System hlášení RDG neshod v ONK, a.s.

Petr Neumann



RDG neshody

1. opakování snímků

1.1 Chybné polohování pacienta
1.2 Pohyb pacienta během expozice
1.3 Nesprávné expoziční parametry
1.4 Nesprávné ID pacienta, záměna pacienta
1.5 Selhání RTG zařízení
1.6 Přítomnost artefaktů
1.7 Prázdný snímek
1.8 Smazání snímku před odesláním do PACS
1.9 Vadná kazeta, folie, detektor
1.10 Jiné důvody

RDG neshody

2. chybné údaje na žiadance

2.1 Chybná identifikace pacienta
2.2 Chybná identifikace odesílajícího lékaře
2.3 Chybějící diagnóza
2.4 Chybné označení strany u párových orgánů
2.5 Chybné označení výkonu
2.6 Duplicita vyšetření
2.7 Chybějící údaj o alergii u pacientů indikovaných k CT, MR a skioskopickému vyšetření s aplikací KL i.v., p.o.
2.8 Chybějící údaj o těhotenství (mimo UZ)
2.9 Chybějící údaj o kojení u potenciálně kontrastních vyšetření (CT, MR)
2.10 Chybějící údaj o hladině sérového kreatininu u rizikových skupin osob u kontrastních vyšetření na CT a MR
2.11 Chybějící údaj o váze a výšce
2.12 Jiné důvody

RDG neshody

3. chyba vyšetření

3.1 Chybějící stranové označení na snímku
3.2 Přítomnost artefaktů, které mohou narušit diagnostickou informaci
3.3 Neuložení v PACS
3.4 Porucha přístroje
3.5 Nestandardní poloha části těla na snímku
3.6 Záměna zobrazovaného úseku či pacienta
3.7 Jiné důvody

RDG neshody

4. ostatní

Jiné než 1.1 – 1.10
Jiné než 2.1 – 2.12
Jiné než 3.1 – 3.7

< >

<vyhledat v nabídce (Ctrl+F)> 🔍

ZPS ZDS OLE

11 11 10 / 0001 999

muž 2 roky 8 měs. 1.1.2017

Alrg.

Cave

Účet [Kč]

Hosp.

Plátce hosp. Hosp. dg.

<Nálepký> ➕

Založit novou klinickou událost

- RTG vyšetření 031
- Výběr pro obrazovou 292
- Vlastní popis klin. udá 811
- Protokol o nežádoucí 872

[illegible]

[Bez náhledu](#)
[Náhled dokumentace](#)
[Náhled zdravotního účtu](#)
[Náhled fakturace](#)
[Pokročilé filtry](#)
[Smazané události](#)

Hlavní panel

Výběr pacienta

Osobní údaje

Klinické události

Nová událost

Hospitalizace

Laboratorní výsledky

Žádanky

Objednávky

Procesy

Poukazy

Neschopenky

Formuláře

Čekárny

Domácí péče

Další údaje

Pořizování účtů

Export lab. žadanek

Kniha objednávek

Strava

Objednávky léků

Operační plán

Plán domácí péče

Dispečink procesů

Statistiky, přehledy

Nastavení

provedeno

vyžádáno

ostatní

procesy

historie dokumentu

Datum provedení

12.8.2019 14:41

Typ a specifikace události

Protokol o nežádoucí události

023 RDG neshody

Stav dokumentace

nezapsáno

rozeepsáno

dokončeno

uzavřeno

Provádějící

klin./odd.

89 RDG

pracoviště

8933 RDG COS

lékař/uživ.

Neumann Petr, Bc.

Vzhled 1

Obrazová dokumentace

Procesy

1) Opakování snímku (vyplňuje RA)

1.2 Pohyb pacienta během expozice

Pacient telefonuje v průběhu expozice!!!

2) Chybné údaje na žadance (vyplňuje RA i lékař)

3) Chyba vyšetření (vyplňuje RA i lékař)

4) Ostatní neshody - mimořádné události (vyplňuje RA i lékař)

5) Vyžádáno od:

OTA

6) Způsob vyřešení neshody

Opakování vyšetření

ZPS ZDS OLE

11 11 10 / 0001

999

muž

2 roky 8 měs.

1.1.2017

Alrg.

Cave

Účet [Kč]

Hosp.

Plátce hosp.

Hosp. dg.

<Nálepky>

Task

Šablony

Bc. Petr Neumann (bez odpovědného lékaře)

8933 RDG COS

Hlavní panel

Výběr pacienta

Osobní údaje

Klinické události

Nová událost

Hospitalizace

Laboratorní výsledky

Žádanky

Objednávky

Procesy

Poukazy

Neschopenky

Formuláře

Čekárny

Domácí péče

Další údaje

Pořizování účtů

Export lab. žádanek

Kniha objednávek

Strava

Objednávky léků

Operační plán

Plán domácí péče

Dispečink procesů

Statistiky, přehledy

Nastavení

Účet [Kč]

Hosp.

Plátce hosp.

Hosp. dg.

Nálepky

Tisk

Šablony

provedeno

vyžádáno

ostatní

procesy

historie dokumentu

Datum provedení

12.8.2019 15:02

Typ a specifikace události

Protokol o nežádoucí události

023 RDG neshody

Vzhled 1

Obrazová dokumentace

Procesy

1) Opakování snímku (vyplňuje RA)

2) Chybné údaje na žádance (vyplňuje RA i lékař)

2.4 Chybné označení strany u párových orgánů

Záměna pravé a levé strany.

3) Chyba vyšetření (vyplňuje RA i lékař)

4) Ostatní neshody - mimořádné události (vyplňuje RA i lékař)

5) Vyžádáno od:

OTA

6) Způsob vyřešení neshody

Upraveno po telefonické domluvě

Stav dokumentace

nezapsáno

rozeepsáno

dokončeno

uzavřeno

Provádějící

klin./odd.

89 RDG

pracoviště

8933 RDG COS

lékař/uživ.

Neumann Petr, Bc.

Bc. Petr Neumann (bez odpovědného lékaře)

8933 RDG COS

Hlavní panel

Výběr pacienta

Osobní údaje

Klinické události

12.8.2019 [87]

Hospitalizace

Laboratorní výsled

Žadanky

Objednávky

Procesy

Poukazy

Neschopenky

Formuláře

Čekárny

Domácí péče

Další údaje

Pořizování účtů

Export lab. žadanek

Kniha objednávek

Strava

Objednávky léků

Operační plán

Plán domácí péče

Dispečink procesů

Statistiky, přehledy

Nastavení

vyhledat v nabídce (Ctrl+F)

PS ZDS OLE

11 10 / 0001

999

už

2 roky 8 měs.

1.1.2017

rg.

ave

čet [Kč]

osp.

átce hosp.

Hosp. dg.

<Nálepky>

provedeno

vyžádáno

ostatní

procesy

historie dokumentu

Datum provedení

12.8.2019 14:59

Typ a specifikace události

Protokol o nežádoucí události

023 RDG neshody

Vzhled 1

Obrazová dokumentace

Procesy

Náhled

Poznámka

IMG-20180607-WA0002

Stav dokumentace

nezapsáno

rozepsáno

dokončeno

uzavřeno

Provádějící

klin./odd.

89 RDG

pracoviště

8933 RDG COS

lékař/uživ.

Neumann Petr, Bc.

VLEZE

L

Xp: 125

mAs: 1.0

1280 dGy*cm²

EI: 469 02

Poslat

Dispozice

Mod kontrol

Zvětšení 1:1

Upravit image

Šířka 16383

Úroveň 8192

Poznámky

1 / 1

Prohlížeč

Načíst dokument(y)

Smazat dokument

Tisk

Šablony

Bc. Petr Neumann (bez odpovědného lékaře)

8933 RDG COS

Hlavní panel

Výběr pacienta

Osobní údaje

Klinické události

12.8.2019 [87]

Hospitalizace

Laboratorní výsledky

Žádanky

Objednávky

Procesy

Poukazy

Neschopenky

Formuláře

Čekárny

Domácí péče

Další údaje

Požírování účtů

Export lab. žádanek

Kniha objednávek

Strava

Objednávky léků

Operační plán

Plán domácí péče

Dispečink procesů

Statistiky, přehledy

Nastavení

provedeno

vyžádáno

ostatní

procesy

historie dokumentu

Datum provedení

12.8.2019 08:25

Typ a specifikace události

Protokol o nežádoucí události

023 RDG neshody

Vzhled 1

Obrazová dokumentace

Procesy

Náhled

Poznámka

20181016_074104

Stav dokumentace

nezapsáno

rozepsáno

dokončeno

uzavřeno

Provádějící

klin./odd.

89 RDG

pracoviště

8933 RDG COS

lékař/uživ.

Neumann Petr, Bc.

5200160

Image Loading has completed.

07:35:35

Image Loading has completed.

3601156

Generator error 50-0204;(4): Heater 0: filament permanent open circuit

07:37:39

Generator error. Try again. Call service if the problem persists.

3601156

Generator error 50-0204;(4): Heater 0: filament permanent open circuit

07:37:39

Generator error. Try again. Call service if the problem persists.

3601156

Generator error 50-0204;(4): Heater 0: filament permanent open circuit

07:37:40

Generator error. Try again. Call service if the problem persists.

3601156

Generator error 50-0204;(4): Heater 0: filament permanent open circuit

07:37:40

Generator error. Try again. Call service if the problem persists.

Select Protocol

Aut

Suspend

Discontinue

kV : 45

mA : 160.0

mAs : 8.0

3

45

kV

8.0

mAs

CAUTION: Digital Detector Unit

Ensure that digital detector unit is properly connected

Head

Back

Foot

ZPS ZDS OLE

11 11 10 / 0001

muž

2 roky 8 měs.

1.1.2017

Alrg.

Cave

Účet [Kč]

Hosp.

Plátce hosp.

Hosp. dg.

<Nálepky>

Task

Šablony

Prohlížeč

Načíst dokumenty


Smazat dokument

1 / 1

Bc. Petr Neumann (bez odpovědného lékaře)

8933 RDG COS

Neshody – radiační události

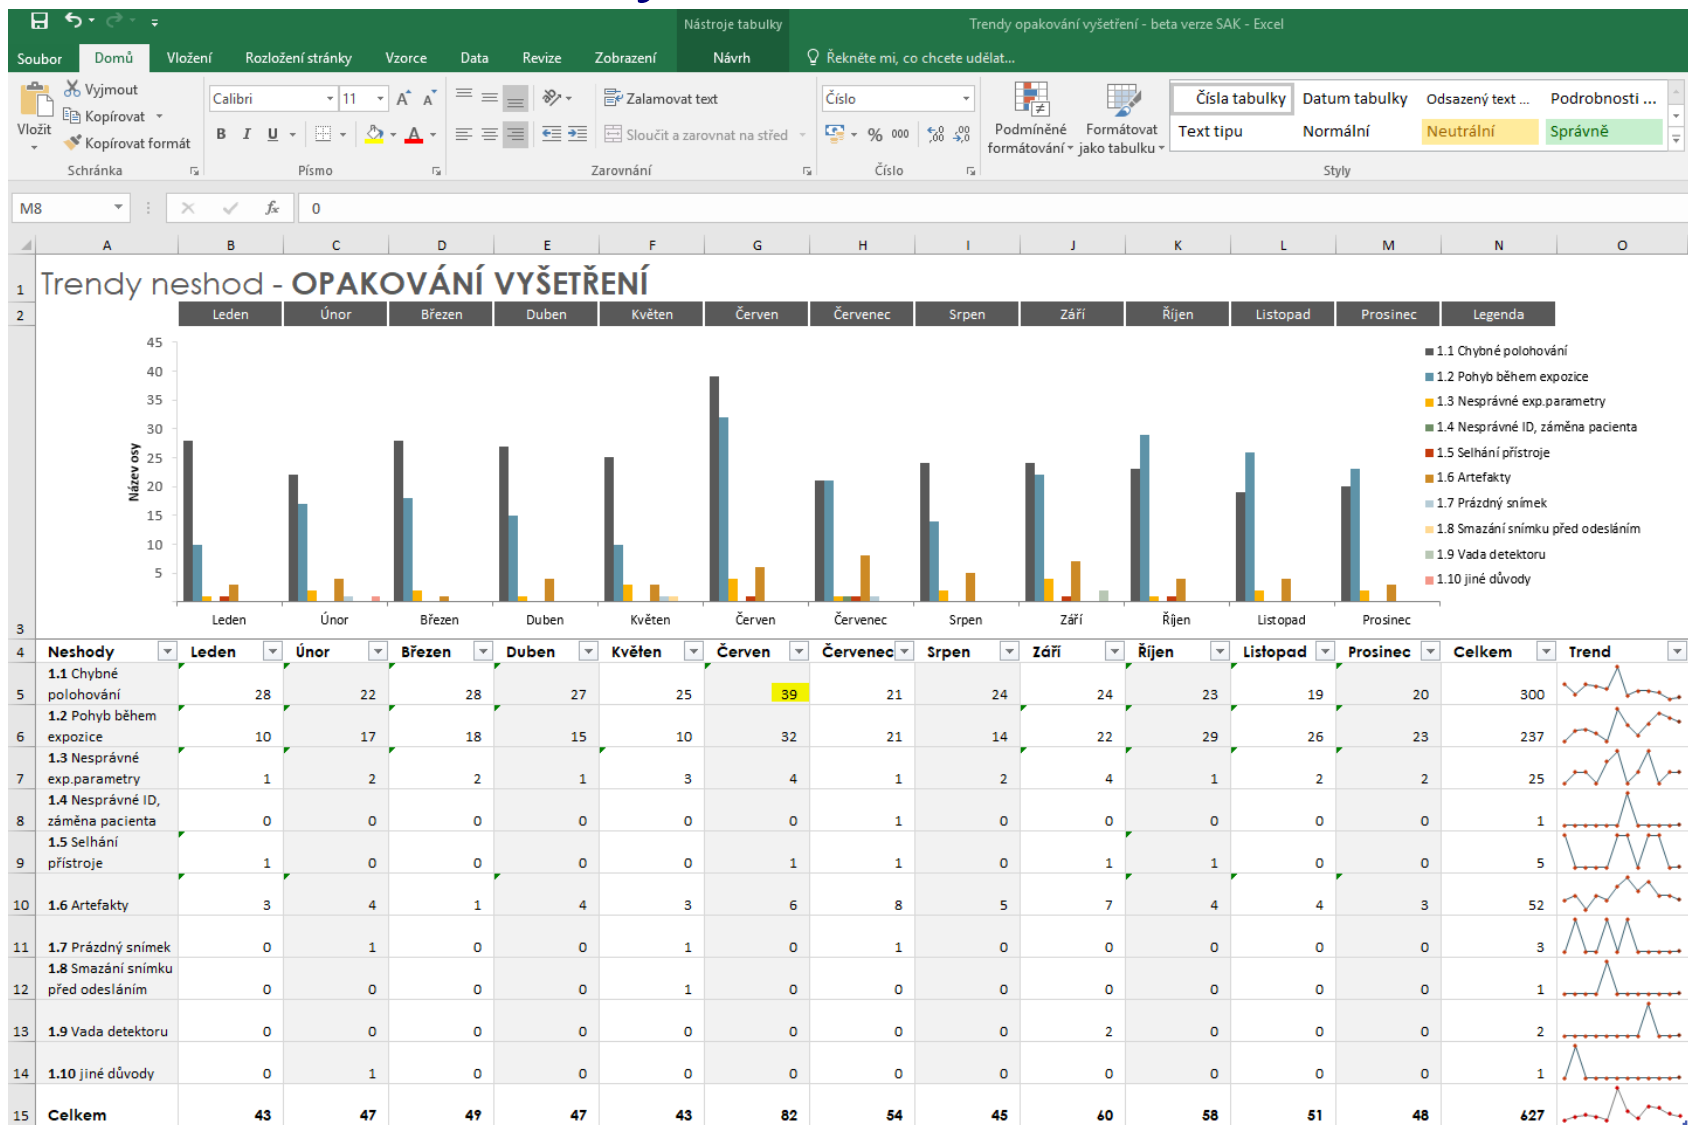



Děkuji za pozornost!

petrk.neumann@nemocnicekolin.cz